راهنمای استعلام سقف قیمت ریالی تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی

۱- کالاهای وارداتی

در استعلام سقف قیمت ریالی کالاهای وارداتی لازم است مراحل ذیل به ترتیب انجام شود:

۱-۱- ورود به سایت www.imed.ir

۱-۲- ورود به قسمت استعلام ، استعلام ترخیص، **استعلام ترخیص با سری ساخت کالا از سال ۱۳۹۵ (نوع ارز)**

تصویر شماره ۱

۱-۳- پس از ورود به صفحه مربوطه، امکان جستجو بر اساس شماره سری ساخت کالا (لات نامبر) و یا کد IRC فراهم می‌باشد.

تصویر شماره ۲

۱-۴- در این مرحله لازم است کد IRC و نیز شماره سری ساخت کالا (لات نامبر) با اطلاعات درج شده روی فاکتور دریافتی از شرکت و نیز اطلاعات درج شده روی بسته‌بندی کالای تحویل گرفته شده مطابقت داده شود.

۱-۵- با کلیک بر روی گزینه **"لیست لات‌نامبر/ سریال نامبر ترخیص شده"** (مطابق تصویر شماره ۳)، نوع تامین ارز (ترجیحی نوع یک، ترجیحی نوع دو و یا غیر ترجیحی) جهت IRC و شماره سری ساخت (لات نامبر) مورد نظر نمایش داده می‌شود.

تصویر شماره ۳

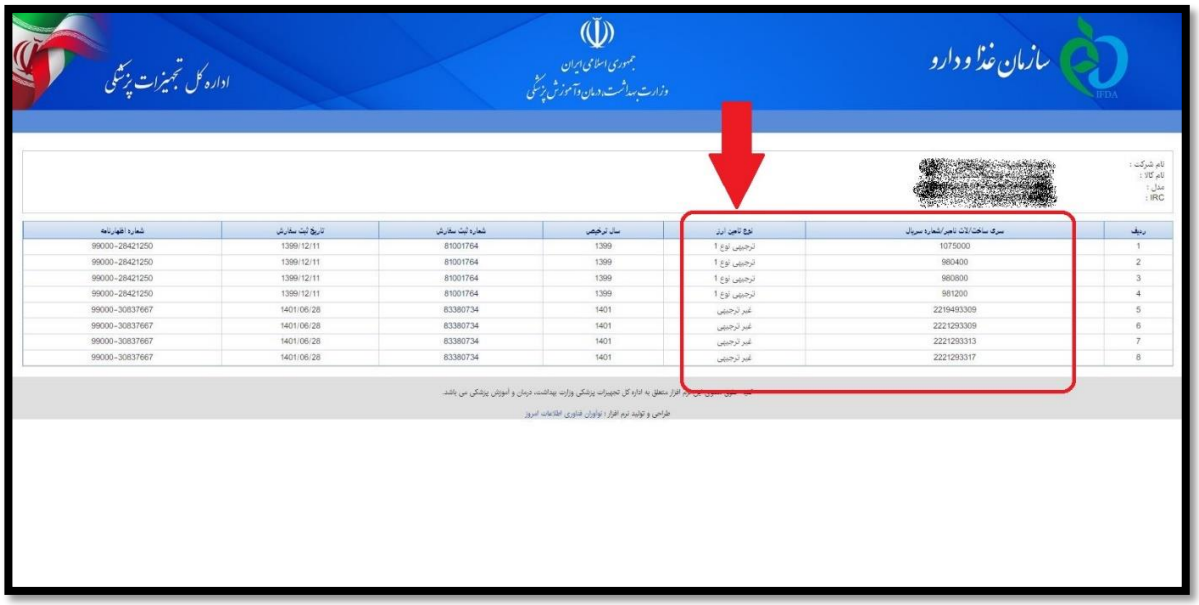

تصویر شماره ۴

۱-۶- در مرحله بعدی از صفحه اصلی سایت www.imed.ir وارد قسمت **"استعلام قیمت"** شده و بر اساس اینکه نوع تامین ارز ترجیحی نوع یک (هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال) و یا ترجیحی نوع دو (هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) بوده است، مطابق تصویر شماره ۵ وارد شوید.

تصویر شماره ۵

۲- کالاهای تولید داخل

۲-۱- در استعلام سقف قیمت ریالی بابت کیت‌های آزمایشگاهی تولید داخل کافی است وارد قسمت استعلام قیمت شده و ابتدا گزینه سقف قیمت ملزومات و تجهیزات پزشکی تولید داخل و سپس گزینه " قیمت اقلام آزمایشگاهی تولید داخل مشمول ارز ترجیحی" را انتخاب نمایید.

تصویر شماره ۶

تصویر شماره ۷

۲-۲- در استعلام سقف قیمت ریالی بابت سایر کالاهای تولید داخل (از جمله دستگاه تست قند خون و نوار تست قند خون تولید داخل) کافی است وارد قسمت استعلام قیمت شده و گزینه سقف قیمت ملزومات و تجهیزات پزشکی تولید داخل، قیمت تجهیزات مصرفی تولیدی جهت مراکز را انتخاب نمایید.

تصویر شماره ۸